

重要

2021年3月吉日

医療機関・福祉施設の皆様へ

社会医療法人 峰和会
鈴鹿回生病院
病院長 加藤 公
(公印省略)

誤接続防止コネクタ（経腸栄養分野）の導入に関するご案内

拝啓 貴施設に置かれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素より当院の運営にご理解とご助力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、厚生労働省発出の「経腸栄養分野の小口径コネクタ製品の切替えについて」（平成30年3月16日付け医政安発0316第1号、薬生薬審発0316第1号、薬生機審発0316第1号、薬生安発0316第1号）を受け、当院では、**2021年4月1日**より、順次、誤接続防止コネクタ製品（新規規格製品）を導入する運びとなりました。

つきましては、連携施設間での混乱を避けるため、当院の導入状況について貴施設と情報共有したく存じます。

なお、ご不明な点がございましたら、以下のお問い合わせ先までご連絡ください。

製品の導入に際し、お手数をおかけしますが、今後の円滑な施設間連携を図るため、何卒ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

参考・関連資料

- ・「経腸栄養分野の小口径コネクタ製品の切替えについて」
平成30年3月16日付け医政安発、薬生薬審発、薬生機審発、薬生安発0316 第1号
厚生労働省医政局総務課医療安全推進室長等連名通知
- ・「PMDA 医療安全情報No. 58 誤接続防止コネクタの導入について（経腸栄養分野）」
独立行政法人医薬品医療機器総合機構

【問い合わせ先】社会医療法人 峰和会 鈴鹿回生病院
担当：医療安全管理課 寺田
電話：059-375-1212（代表）

誤接続防止コネクタの導入に関するご案内

厚生労働省通知を受け、国際規格に合わせた経腸栄養分野の誤接続防止コネクタ製品（新規格製品）を導入する運びとなりました。

当院の切り替え予定

2021年4月1日から新規格製品を導入し、順次切り替えを行う予定です。


※新規格製品の供給都合上、一部製品は旧規格製品を使用して退院する場合がございます。

今後の対応


切り替え日以降に当院から退院する患者様は、右図の新規格製品を使用します。この新規格製品に接続するためには、

- ・ 新規格製品同士を直接接続する
- ・ 「変換コネクタ」を介して旧規格製品と新規格製品を接続する

上記のいずれかで対応する必要があります。特に旧規格と新規格で異なる接続を行う場合には、「変換コネクタ」がないと接続できません。

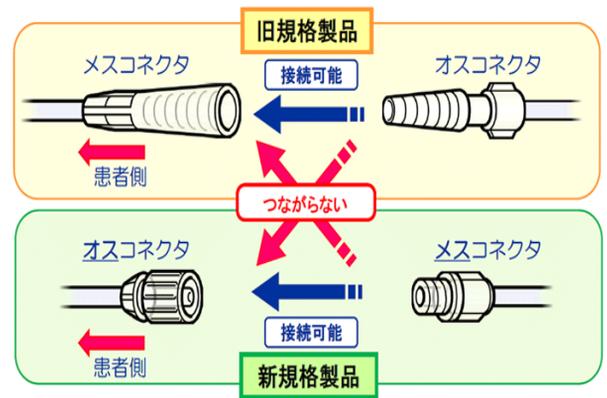

図：独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）ウェブサイトより引用

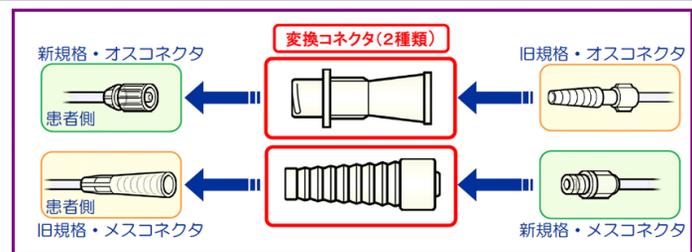

図：独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）ウェブサイトより引用

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 経鼻栄養用カテーテル | <input checked="" type="checkbox"/> 胃ろう用カテーテル
(PEGチューブ・ボタン) |
| <input checked="" type="checkbox"/> 経腸栄養投与セット | <input checked="" type="checkbox"/> 注入器（栄養用） |
| <input checked="" type="checkbox"/> 経腸栄養用延長チューブ | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 経腸栄養用活栓 | 等 |

連携施設様へのお願い

2021年4月1日以降については、貴施設におかれましても「変換コネクタ」のご準備、もしくは新規格製品への切り替えをお願い致します。